


**MAATWERKSCHEMA • TABLEAU SUR MESURE
MEDISCHE COMPRESSIEKOUSEN • BAS DE COMPRESSION THERAPEUTIQUES**

TOVARIX □ 20/I □ 20/II □ 50/I □ 50/II □ 50/III □ 70/II □ 70/III

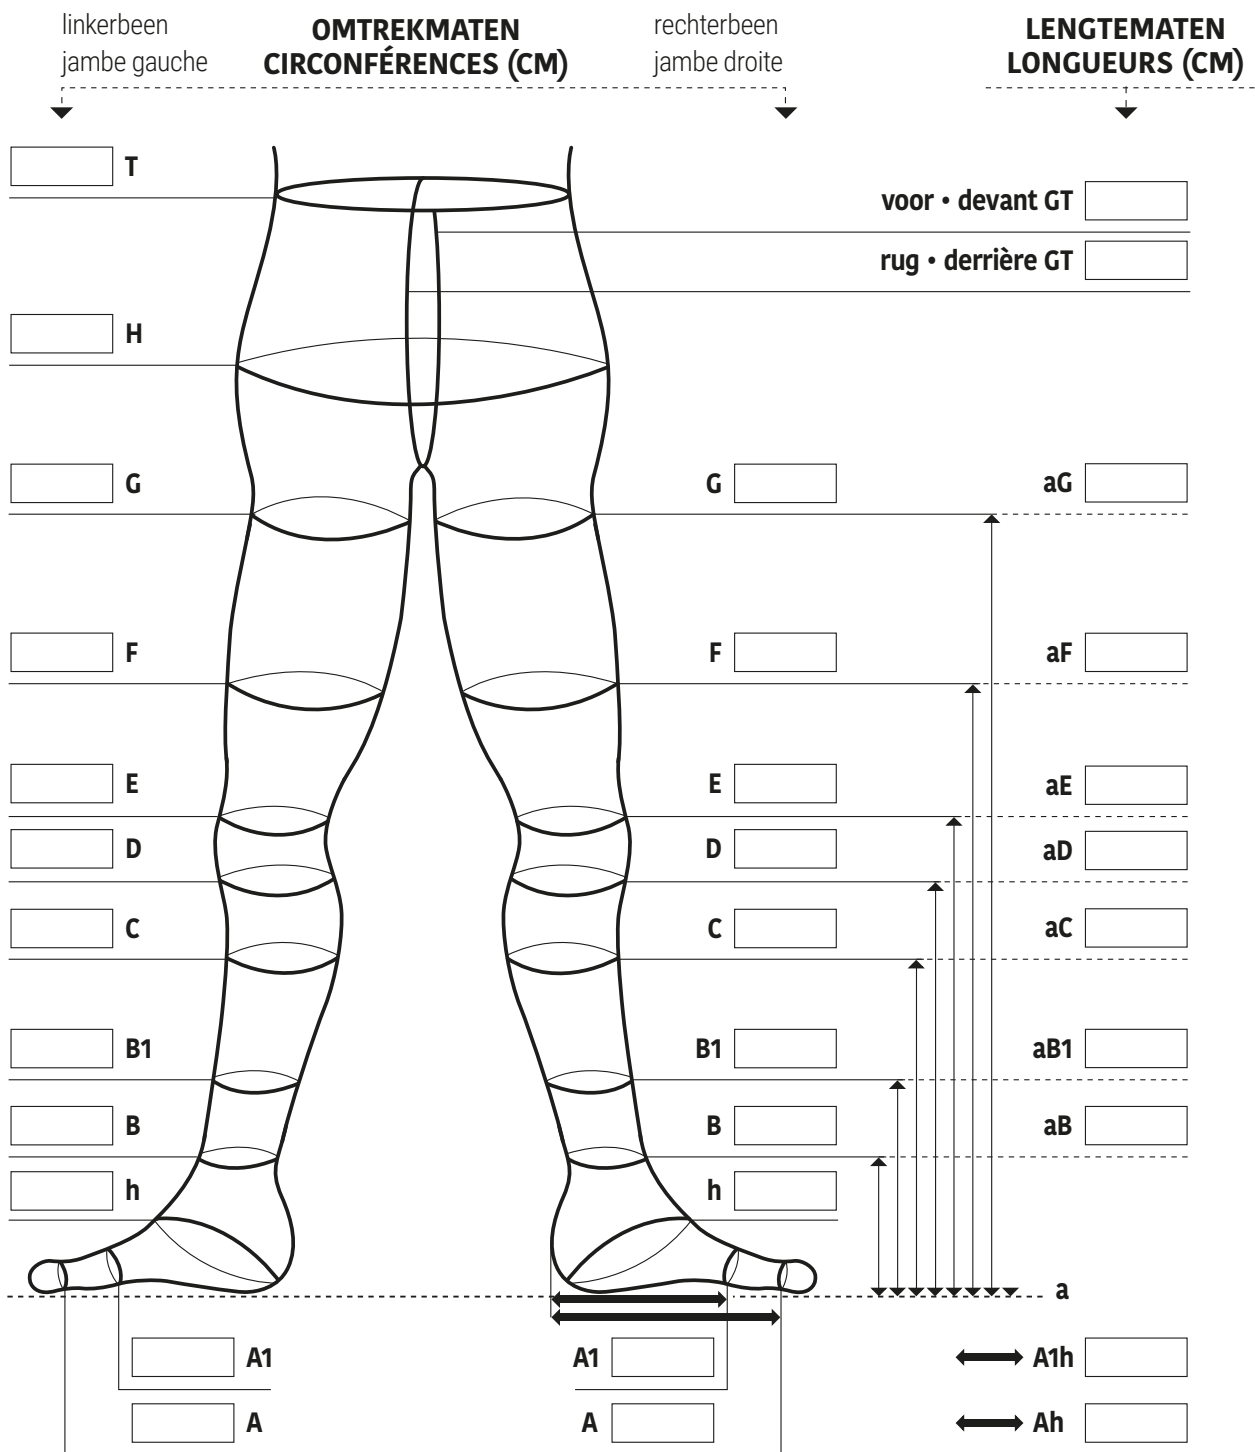

De omtrekmaten moeten bij voorkeur 's morgens op een ontzwollen been genomen worden.

De medische hulpverlener is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Les mesures doivent de préférence être prises le matin, lorsque les jambes ne sont pas gonflées.

Exactitude des mesures sous votre entière responsabilité.

Afzender • Expéditeur :

Stuur/fax dit naar • Envoyer/faxer à :

Bota nv
Stadionlaan 12-16 - B-9800 Deinze
Tel.: +32 9 386 11 78 - Fax: +32 9 386 50 93
info@bota.be